

ソルデム1輸液 200mL品 容器・包装変更のご案内

2026年10月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、ソルデム1輸液200mL品につきまして、下記のとおり、容器および包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。


謹白

記

■ 変更内容


- ①製品本体（バッグ）の仕様および表示デザインを変更いたします。
また、ゴム栓部のシール（袋口シール）を「透明」から「白色（不透明）」に変更いたします。

変更前



袋口
シール有


変更後



袋口
シール有

	変更前	変更後
材質	バッグ：PP、ゴム 袋口シール：PET、PP	バッグ：PE、ゴム 袋口シール：PET、PP
寸法	全長 約236mm×幅 約109mm	全長 約210mm×幅 約130mm
シートの厚み	約270μm	約250μm
空バッグ重量	約18.7g	約20.1g
予備容量	約100mL	約190mL
ゴム栓穿刺面径	φ 12.2mm	φ 15mm

② 包装袋の仕様および表示を変更いたします。また、6袋入りから5袋入りに変更となります。

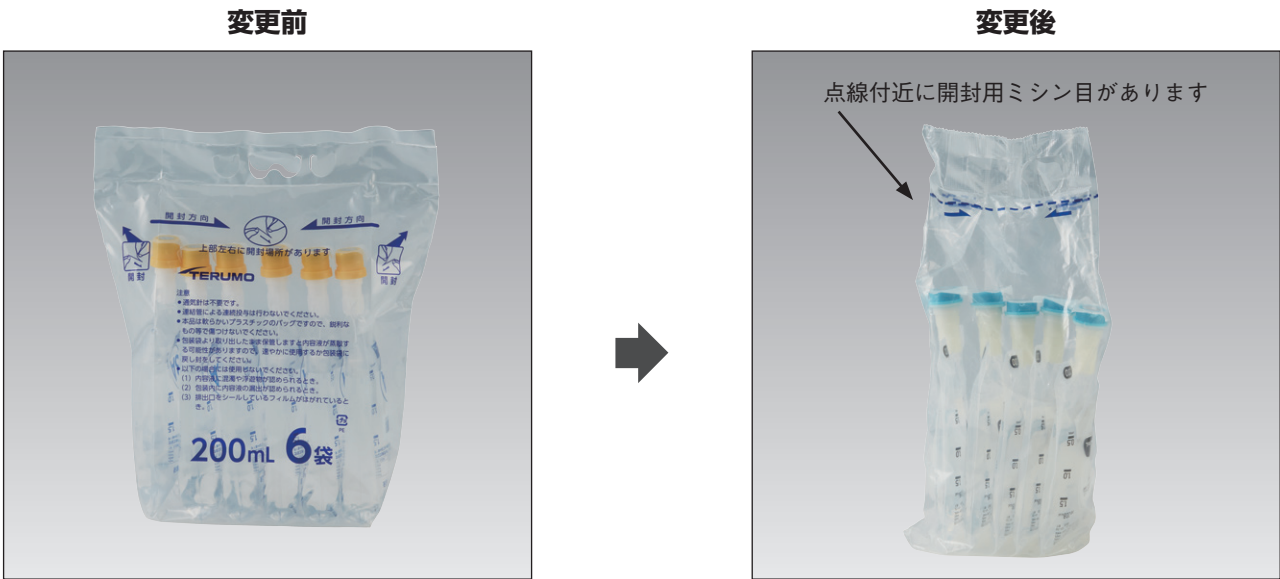

(注意) 写真は200mL品の代表例であり、排出口の色は実物とは異なります。

③ 出荷箱のサイズおよび表示デザインを変更いたします。また、カッターナイフを使わずに封かんテープを剥がせる仕様に変更いたします。



幅(W)520mm×奥行(D)185mm×高さ(H)223mm
約7.4kg

幅(W)270mm×奥行(D)267mm×高さ(H)237mm
約5.1kg

〈開封方法〉

開封用ミシン目を押し込み、テープをつかみ、引き上げます。



④ 入り数を変更いたします。このため、電子添文の22.包装の項も改訂いたします。

改訂前	改訂後（下線：改訂箇所）
22.包装 200mL×30袋 500mL×20袋	22.包装 200mL× <u>20</u> 袋 500mL× <u>20</u> 袋

■ **変更開始時期** 2026年12月
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ **変更対象品種**
ソルデム 1 輸液 (200mL)

変更前 (入り数 : 30袋)

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード
TP-A02GM1V	350088710	 (01)04987350088727	 (01)14987350088717	1077223010103



変更後 (入り数 : 20袋)

コード番号	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	HOTコード	開始ロット
TP-AC02GM1	892153631	 (01)04987892153648	 (01)14987892153638	1077223010201	未定

※なお、一定期間、出荷箱に貼付しておりますラベルに「仕様変更品」の追記をさせていただきます。

