

お客様各位

サフィードネラトンカテーテル 包装表示変更のご案内

2024年3月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、サフィードネラトンカテーテルにつきまして、下記のとおり、包装表示の変更いたしますので、ご案内申し上げます。なお、詳細につきましては、弊社担当者にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記


■変更内容

①個包装および単位箱ラベルに「有効長」を追加いたします。


これに伴い表示レイアウトが若干変更になります。

<個包装>

変更前(代表例)

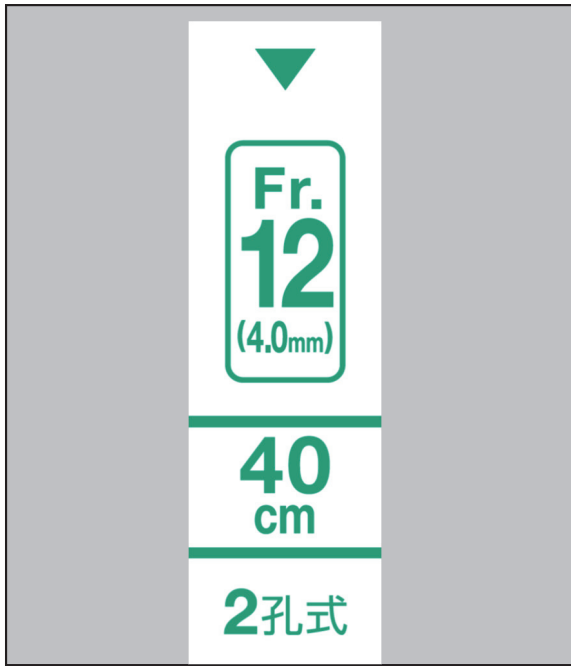

変更後(代表例)

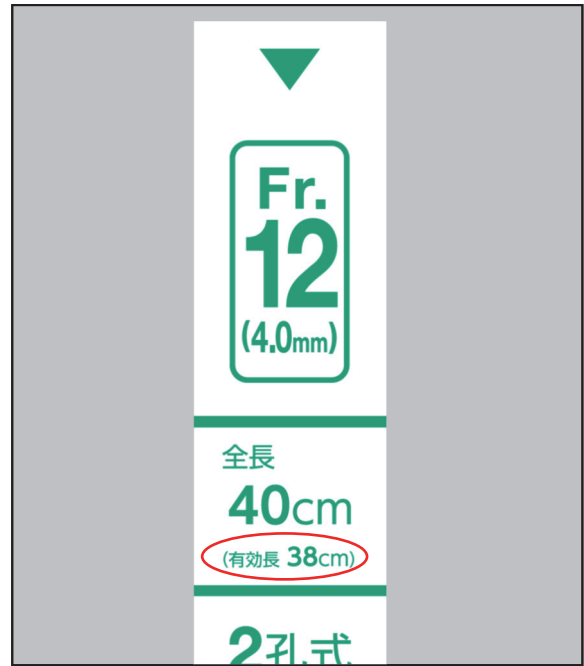

自己導尿タイプ

変更前(代表例)



変更後(代表例)



<単位箱ラベル>

変更前(代表例)




変更後(代表例)




②単位箱に「超音波検知可能」の表示を追加いたします。

変更前

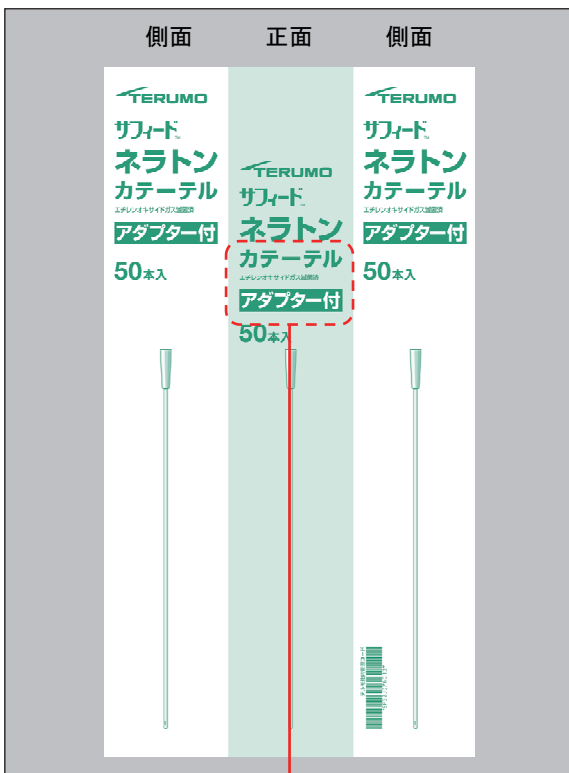

変更後

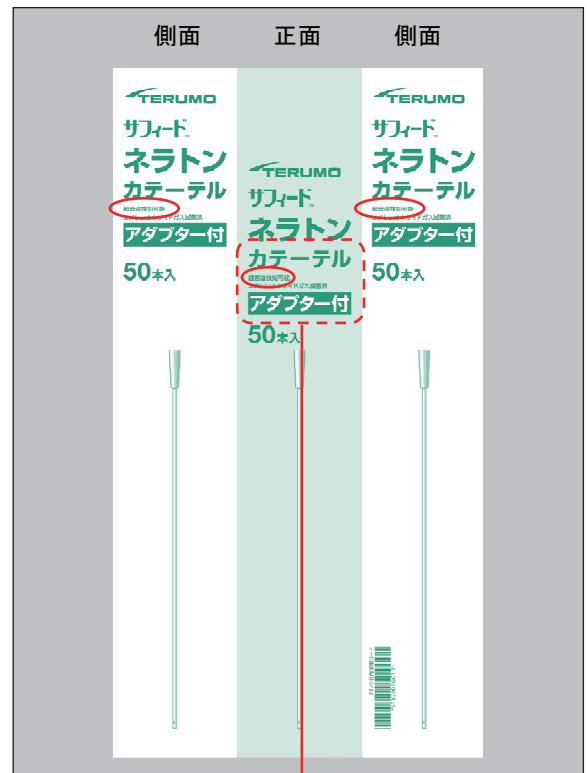

変更前



変更後



- **変更開始時期** 2024年3月より順次
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。
- **変更対象品種**

サフィードネラトンカテーテル	全品種
サフィードネラトンカテーテル(自己尿道タイプ)	全品種

一般的名称：間欠泌尿器用カテーテル

販売名：サフィードネラトンカテーテル 医療機器認証番号：15000BZZ00896000